Attachment B3.3

Field Analyzer Calibration

Attachment B3.3

Field Analyzer Calibration

No	Description	M, mg	Mass Hg, mg	C, mg/kg	Area	Maximum	Time
3	Std__6.25	61	0.000381250	6.8	156000	15500	1:18:11 PM
4	Std__6.25	27	0.000168750	5.5	56400	10300	1:21:59 PM
5	Std__6.25	172	0.001075000	6.1	396000	37600	1:25:40 PM
6	Std__6.25	98	0.000612500	6.5	242000	32900	1:30:49 PM

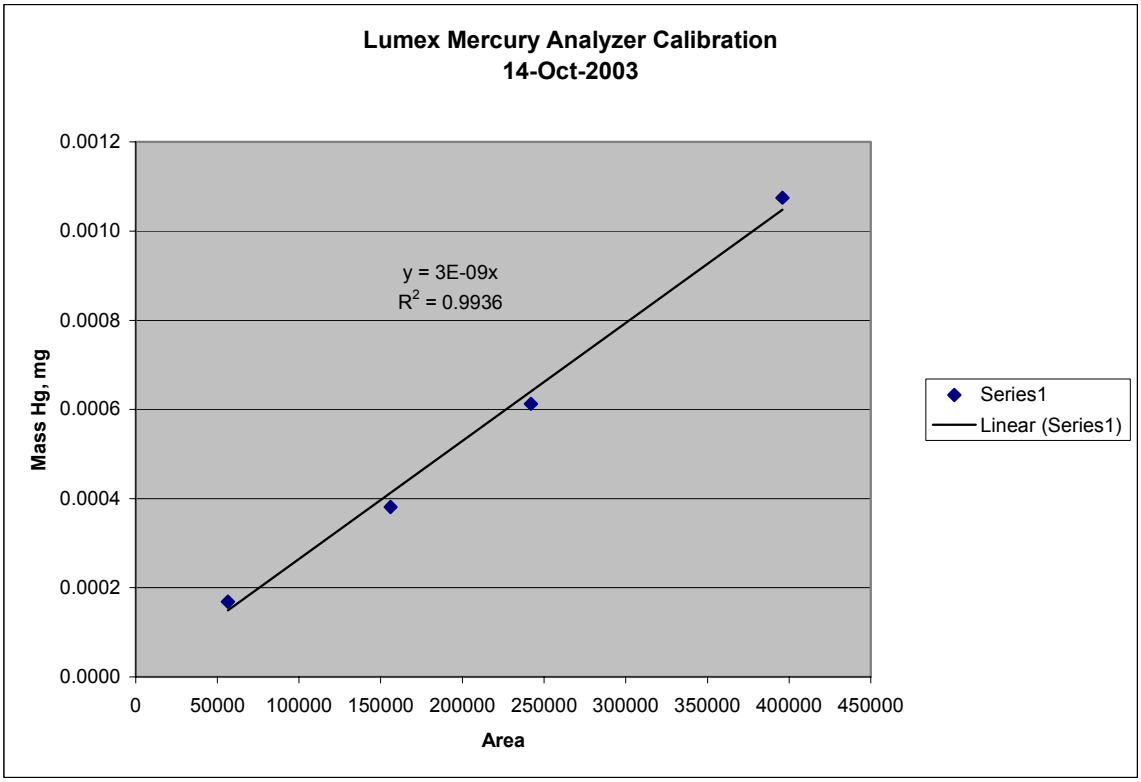

Figure B3.3-1. Lumex Mercury Analyzer calibration.

Attachment B4

Pictures of Sample Point 6-3 Excavation

Attachment B4.1

Pictures of Sample Point 6-3 Prior to Excavation

Attachment B4.1

Pictures of Sample Point 6-3 Prior to Excavation

Attachment B4.2

Pictures of Sample Point 6-3 After Excavation

Attachment B4.2
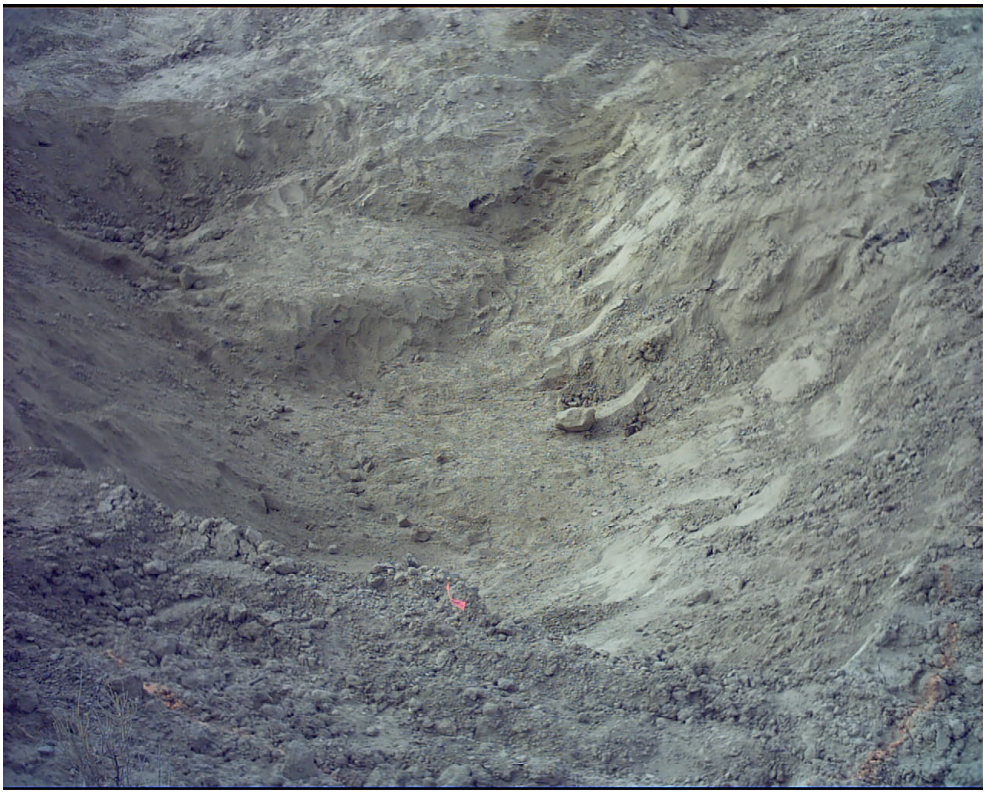
Pictures of Sample Point 6-3 After Excavation